

安捷伦 7697 许可证丢失导致的联机失败

张智慧, 黄河

(1.四川省化工质量安全检测研究院, 四川 610031)

摘要: 安捷伦 7697 顶空进样器联机失败, 经排查为许可证丢失, 翻箱倒柜的找出许可证, 输入后正常。

关键词: 7697 顶空, chemstation, 许可证丢失

单位上一台 7697 顶空搭配了 7890A 气相, 用来做食品添加剂油墨等样品。今天准备做个食品添加剂的溶剂残留, 顶空气相开机自检正常, 可是打开工作站时, 报错, 提示无法启动仪器仪器 该仪器不可用或被删除, 如图 1。不应该啊, 这仪器谁会手痒去删它呢?

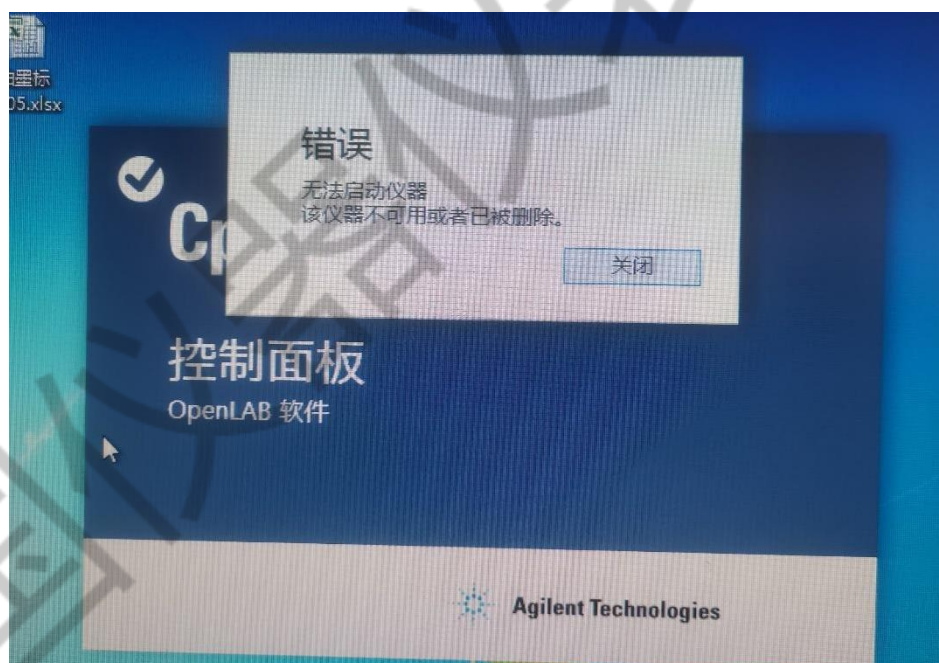


图 1

打开控制面板, 尝试重新配置仪器。气相很容易的配置成功, 可是顶空这里出问题了。许可证不见

了，版本信息也全为圈圈。许可证没了后面肯定没了，如图 2

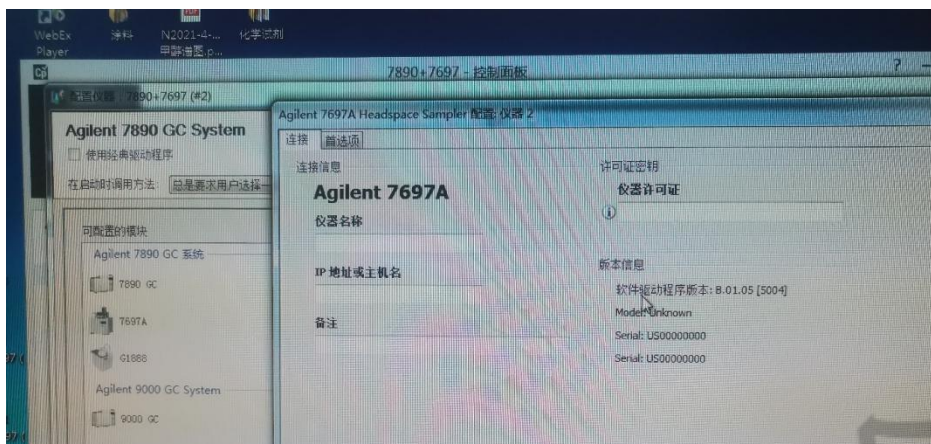


图 2

没有许可证，电脑里也没有备份。很早前用过，就再次翻箱倒柜的找。咨询了工程师，许可证是 AAAA-BBBB-CCCC-DDDD 格式。经过不懈努力，找到了一个像是许可证的袋子，如图 3。不知道是不是，这个袋子上只有一个 Product Number，没有名称，只能试试了。



图 3

输入上面的序列号，哇哦，居然可以了。再输入仪器名称和 IP 地址，IP 地址可以通过顶空面板上的 config/通讯里查看，如图 4